FUJICO

内閣総理大臣表彰
ものづくり日本大賞
フジコーの取組みと技術が認められ、
世界トップの高殺菌・消臭分解機能製品の開発
で、経済産業大臣賞特別賞を受賞！

空気消臭殺菌装置
マスクリーン MC-T1

PM2.5 対応

驚きの 消臭力
たばこやアンモニアなどのにおいを素早く分解

圧倒的な 殺菌力
インフルエンザやカビ菌を撃退

ハイブリッド光触媒 ＋ マイナスイオン で空気浄化

使用シーン
事務所 / 病 院 / 薬 局 / レストラン / 焼肉屋

内蔵のハイブリッド光触媒「MaSSC」が菌やにおいを強力に分解・除去

風量は3段階「弱」「中」「強」
切タイマーは「1H」「4H」「8H」

取っ手がついて持ち運びも楽々

リモコンで離れたところからも操作可能

フジコーの独自の溶射技術で、高密度・高効率のハイブリッド光触媒を実現。
フジコー独自の溶射技術により生み出された、今までにない高機能ハイブリッド光触媒「MaSSC（マスク）」。
紫外光だけでなく、蛍光灯などの室内光でもチカラを発揮します。驚きの殺菌・消臭力を体感して下さい。

空 気 消 臭 殺 菌 装 置

MaSSC CLEAN

マスクリーン MC-T1【約28畳用(46㎡)】

本体寸法：幅570㎜×奥行175㎜×高さ450㎜
付属機能：安全スイッチ、切タイマー(1H,4H,8H)、表示ランプ調整
付 属 品：リモコン
カ ラ ー：1色(ホワイト)

商品のお問い合わせは
株式会社マスクフジコー 0120-80-2450 月〜金／9:00〜17:00（祝日・年末年始は除く）

販売価格　150,000円(税別)

● 実証試験で裏付けされた高性能

※試験結果は実空間で同様の結果を保証する物ではありません。※実際の効果は使用状況によって異なります。

消臭性能

① タバコ臭の原因(アルデヒド系)

【アセトアルデヒド分解試験】
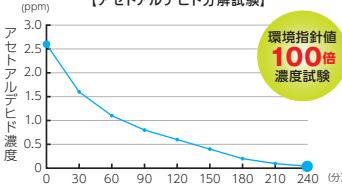
② 体臭・ペット臭の原因(アンモニア)

【アンモニア分解試験】
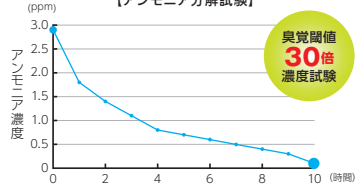
③ シックハウスの原因(VOC系)

【トルエン分解試験】

有害粒子除去性能

① タバコ粒子・PM2.5
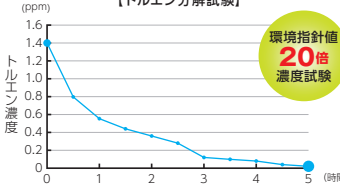
【浮遊粒子除去試験】

●環境指針値:科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響を受けないであろうと判断される値　●臭覚閾値:人間がやっと関知できる濃度
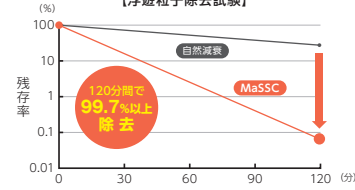
除菌・抗ウイルス性能

① エアコン臭の原因(カビ類)

【浮遊カビ除去試験】
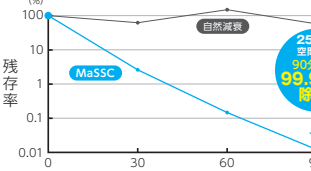
② 浮遊菌・ウイルス

【浮遊ウイルス除去試験】

③ インフルエンザウイルス

【浮遊インフルエンザウイルス不活化試験】
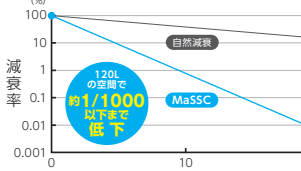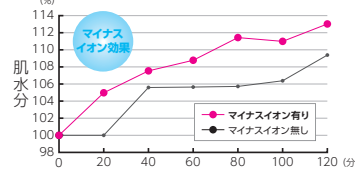
美肌効果性能

① 美肌効果(保湿)

【肌水分量試験】

①試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター②試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター③試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:INNOVA製光音響マルチガスモニター①試験機関:社内・技術開発センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(T1型)を稼動/測定装置:TSI製レーザー式パーティクルカウンター(1μm〜5μm)①試験機関:㈶北里環境科学センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(M型)を稼動/試験対象:アオカビ②試験機関:㈶北里環境科学センター/試験方法:25m³空間内で当社空気清浄機(M型)を稼動/試験対象:大腸菌ファージ③試験機関:BMSA(バイオメディカルサイエンス研究会)/試験方法:BMSA開発グローブボックス(容量120L)内で当社空気清浄機(C型)稼動/試験対象:インフルエンザウイルスA香港型(H3N2)/ウイルス捕捉装置:ザルトリウス製ゼラチンフィルター①試験機関:㈱総合医科学研究所(㈱村田製作所提供)/温度条件:常温常湿/試験環境:25m³/マイナスイオン量:85k個/cc/被験者:女性6名(20〜65歳)※①当社空気清浄機にはマイナスイオン発生器として㈱村田製作所製「イオニシモ®」を搭載

● 製品仕様

型名	MC-T1		
適用床面積	約28畳(46m²)		
電源	ACコンセント(100V・50/60Hz)		
モード	弱	中	強
風量	1m³/min	5m³/min	8m³/min
消費電力	85W	92W	110W
運転音	27dB	40dB	50dB
外形寸法	幅570㎜×奥行175㎜×高さ450㎜		
本体重量	約10kg		
電源コード	約2.0m		
付属機能	安全スイッチ、切タイマー(1H,4H,8H)、表示ランプ調整		
付属品	リモコン		
カラー	ホワイト		

⚠ 安全に関するご注意

安全に正しくお使いいただく為に、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

■当カタログに記載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。■当カタログに記載の製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません(非防水)。■濡れた手でスイッチ操作を行わないでください。■本製品は医療機器ではありません。■ペースメーカーをご使用されている方は、ペースメーカーに影響をきたす場合がありますので絶対に使用しないでください。■実際の効果は、ご使用状況・ご使用時間・個人により異なります。

保証書に関するお願い　商品には、保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入期日の記載のない物は無効となります。

お問い合わせ先

株式会社マスクフジコー
月〜金/9:00〜17:00
(祝日・年末年始は除く)

0120-80-2450

■メールでのお問い合わせ
masscfujico@kfjc.co.jp

【製造元】
株式会社フジコー　環境事業本部　若松響工場
〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1丁目110-5

【販売元】
株式会社マスクフジコー
〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目5番18号 ランドスペース馬借2F

〈販売店〉

ハイブリッド光触媒「MaSSC(マスク)」の詳しい情報は…

http://www.massc.jp/

このカタログの内容は 2013 年 10 月現在のものです。

●製品の色は、印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合がございます。
●製品のデザイン、仕様などは、改善のため予告なく変更する場合があります。